

**L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'UN FORN D'HIBRIDACIÓ PER A MICROARRAYS, DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'EQUIP GENETITAN A LA VERSIÓ "MULTICHANNEL" I DEL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE L'ESMENTAT EQUIP GENETITAN, DESTINATS A LA UNITAT D'ALTA TECNOLOGIA (UAT) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR)**

**2018-037- FORN D'HIBRIDACIÓ PER A MICROARRAYS (LOT 1) + ACTUALITZACIÓ EQUIP GENETITAN A VERSIÓ MULTICHANNEL (LOT 2) + MANTENIMENT DE L'EQUIP GENETITAN (LOT 3)**

En data 20 de Desembre de 2018 s'ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació relatiu als ***"subministrament d'un forn d'hibridació per a microarrays, de l'actualització de l'equip Genetitan a la versió "multichannel" i del manteniment preventiu i correctiu de l'esmentat equip Genetitan, destinats a la Unitat d'Alta Tecnologia (UAT) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)"***.

La licitació objecte d'aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 26 de novembre de 2018, i la data màxima per a la presentació d'ofertes segons els terminis mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va finalitzar el passat 11 de desembre de 2018.


Tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.1 de data 13 de desembre de 2018, la documentació presentada no contenia defectes esmenables:

- LOT 1: FORN D'HIBRIDACIÓ PER A MICROARRAYS
  - LIFE TECHNOLOGIES, S.A
  
- LOT 2: ACTUALITZACIÓ EQUIP GENETITAN A VERSIÓ MULTICHANNEL
  - LIFE TECHNOLOGIES, S.A
  
- LOT 3: MANTENIMENT DE L'EQUIP GENETITAN
  - LIFE TECHNOLOGIES, S.A

El 19 de desembre de 2018, va procedir-se a la realització de l'obertura del sobres amb les ofertes avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.2.

Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s'ha anat reproduint tenint en compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb el quadre de puntuacions de cada lot:



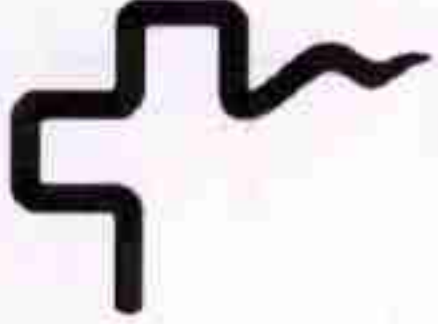

## LOT 1

**Característiques qualitatives i tècniques del subministrament dels productes i serveis inclosos a la licitació.....MÀXIM 50 PUNTS**

**6.1.1 Memòria tècnica i organització: ..... 45 punts**

- Memòria d'especificacions tècniques de l'equip a subministrar.
- Organització i mitjans de subministrament.
- Certificat de l'adjudicatari conforme disposa d'un sistema de qualitat tipus ISO9001:2015 o semblant.

**6.2.1 Millores addicionals: ..... 5 punts**

- Ampliació de la garantia partint de la base que s'ha establert un termini mínim de garantia de dos (2) anys.

## LOT 2

**Característiques qualitatives i tècniques del subministrament dels productes i serveis inclosos a la licitació.....MÀXIM 50 PUNTS**

**6.1.2 Memòria tècnica i organització: ..... 45 punts**

- Memòria d'especificacions tècniques de les actualitzacions a realitzar
- Organització i mitjans de per a la prestació del servei
- Certificat de l'adjudicatari conforme disposa d'un sistema de qualitat tipus ISO9001:2015 o semblant.

**6.2.2 Millores addicionals: ..... 5 punts**


- Ampliació de la garantia, partint de la base que s'ha establert un termini mínim d'un (1) any.

## LOT 3

**Característiques qualitatives i tècniques del subministrament dels productes i serveis inclosos a la licitació.....MÀXIM 50 PUNTS**

2



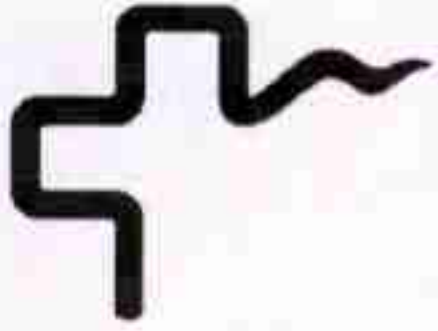

**6.1.3 Memòria tècnica i organització: ..... 45 punts**

- Pla de treball i organització per al servei de manteniment preventiu i correctiu.
- Certificat de l'adjudicatari conforme disposa d'un sistema de qualitat tipus ISO9001:2015 o semblant.

**6.2.3 Millores addicionals: ..... 5 punts**

- Reducció del temps de resposta (menys de 3 hores per a l'atenció remota inicial, menys de 3 dies laborables per a la resolució d'averies in situ) .....3 punts
- Ampliació del serveis de manteniment preventiu (LOT 3) per incloure les estacions fluídiques del sistema GCS3000 del que forma part el forn d'hibridació d'arrays demanat al LOT 1 ..... 2 punts

Exposat l'anterior, s'indica a continuació la puntuació que s'ha assolit per cada lot:

**LOT 1: FORN D'HIBRIDACIÓ PER A MICROARRAYS**

**Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: ..... 45 punts**


<b><u>CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNIQUES</u></b>	<b>LIFE TECHNOLOGIES, S.A</b>
<b>Memòria tècnica i organització. <i>(màx. 45 punts)</i>.</b>	<b>45</b>
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>45</b>

**Justificació de les valoracions:**

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix les especificacions tècniques requerides. En conseqüència, se li atorga la màxima puntuació.

**Millores Addicionals ..... 5 punts**



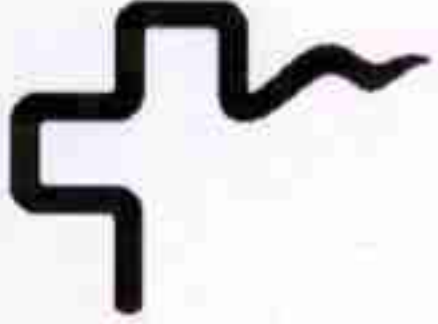

<b>MILLORES ADDICIONALS</b>	<b>LIFE TECHNOLOGIES, S.A</b>
Ampliació de la garantia partint de la base que s'ha establert un termini mínim de garantia de dos (2) anys.	0
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>0</b>

**Justificació de les valoracions:**

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix les especificacions tècniques requerides, si bé no especifica la durada de la garantia de l'aparell subministrat. Per tant s'assumeix que aquesta és de 2 anys i no s'atorga cap puntuació a l'apartat de millores addicionals.

**LOT 2: ACTUALITZACIÓ EQUIP GENETITAN A VERSIÓ MULTICHANNEL**


**Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: ..... 45 punts**

<b>CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNIQUES</b>	<b>LIFE TECHNOLOGIES, S.A</b>
<b>Memòria tècnica i organització. <i>(màx. 45 punts)</i>.</b>	45
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>45</b>

**Justificació de les valoracions:**

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix les especificacions tècniques requerides. En conseqüència, se li atorga la màxima puntuació.



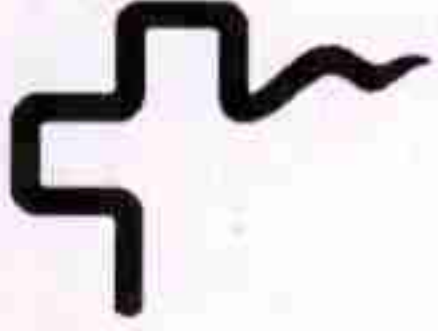

**Millores Addicionals ..... 5 punts**

<b>MILLORES ADDICIONALS</b>	<b>LIFE TECHNOLOGIES, S.A</b>
Ampliació de la garantia, partint de la base que s'ha establert un termini mínim d'un (1) any.	0
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>0</b>

**Justificació de les valoracions:**

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix les especificacions tècniques requerides, si bé no amplia la garantia de les peces reemplaçades (escàner i estació de treball) a més d'un any. Per tant, no s'atorga cap puntuació addicional en aquest apartat.

**LOT 3: MANTENIMENT DE L'EQUIP GENETITAN**

**Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: ..... 45 punts**


<b>CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNIQUES</b>	<b>LIFE TECHNOLOGIES, S.A</b>
Memòria tècnica i organització. <i>(màx. 45 punts).</i>	45
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>45</b>

**Justificació de les valoracions:**

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix els requisits establerts tant en relació amb el manteniment preventiu com al correctiu. En conseqüència, se li atorga la màxima puntuació.

**Millores Addicionals ..... 5 punts**



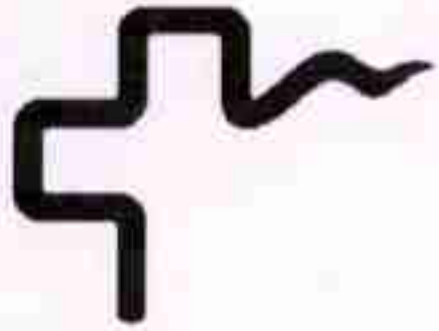

<b>MILLORES ADDICIONALS</b>	<b>LIFE TECHNOLOGIES, S.A</b>
Reducció del temps de resposta (menys de 3 hores per a l'atenció remota inicial, menys de 3 dies laborables per a la resolució d'averies in situ) .....3 punts	0
Ampliació del serveis de manteniment preventiu (LOT 3) per incloure les estacions fluídiques del sistema GCS3000 del que forma part el forn d'hibridació d'arrays demanat al LOT 1 ..... 2 punts	0
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>0</b>

### Justificació de les valoracions:


L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. no proporciona cap de les millores addicionals incloses en aquest apartat. En conseqüència, no se li atorga cap punt addicional.

A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual s'acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui lloc l'obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 2 de gener de 2018 a les 9:00h a la Sala de Reunions de la 2ª Planta de l'Edifici Mediterrània, tal i com s'anuncia a les bases de la present licitació publicades a la web del VHIR.

### LOT 1

<b>QUADRE DE PUNTUACIONS</b>							
<b>Ofertes presentades:</b>	Oferta econòmica			50%	45%	5%	
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Econòmica.	Aspectes Tècnics	Millores	TOTAL
LIFE TECHNOLOGIES, S.A					<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>



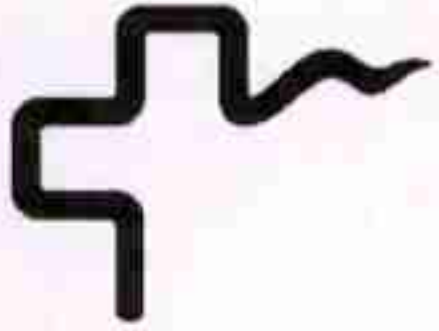

## LOT 2

QUADRE DE PUNTUACIONS							
Ofertes presentades:	Oferta econòmica			50%	45%	5%	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Econòmica.	Aspectes Tècnics	Millores	
LIFE TECHNOLOGIES, S.A					45	0	45

## LOT 3

QUADRE DE PUNTUACIONS							
Ofertes presentades:	Oferta econòmica			50%	45%	5%	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Econòmica.	Aspectes Tècnics	Millores	
LIFE TECHNOLOGIES, S.A					45	0	45

Barcelona, 20 de Desembre de 2018.

**Dra. Rosario M. Prieto Sánchez**  
Cap de la Unitat d'Alta Tecnologia (UAT).  
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).