



L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'UN FORN D'HIBRIDACIÓ PER A MICROARRAYS, DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'EQUIP GENETITAN A LA VERSIÓ "MULTICHANNEL" I DEL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE L'ESMENTAT EQUIP GENETITAN, DESTINATS A LA UNITAT D'ALTA TECNOLOGIA (UAT) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR)

2018-037- FORN D'HIBRIDACIÓ PER A MICROARRAYS (LOT 1) + ACTUALITZACIÓ EQUIP GENETITAN A VERSIÓ MULTICHANNEL (LOT 2) + MANTENIMENT DE L'EQUIP GENETITAN (LOT 3)

En data 20 de Desembre de 2018 s'ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació relatiu als **"subministrament d'un forn d'hibridació per a microarrays, de l'actualització de l'equip Genetitan a la versió "multichannel" i del manteniment preventiu i correctiu de l'esmentat equip Genetitan, destinats a la Unitat d'Alta Tecnologia (UAT) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)"**.


La licitació objecte d'aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 26 de novembre de 2018, i la data màxima per a la presentació d'ofertes segons els terminis mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va finalitzar el passat 11 de desembre de 2018.

Tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.1 de data 13 de desembre de 2018, la documentació presentada no contenia defectes esmenables:

- LOT 1: FORN D'HIBRIDACIÓ PER A MICROARRAYS
 - LIFE TECHNOLOGIES, S.A
- LOT 2: ACTUALITZACIÓ EQUIP GENETITAN A VERSIÓ MULTICHANNEL
 - LIFE TECHNOLOGIES, S.A
- LOT 3: MANTENIMENT DE L'EQUIP GENETITAN
 - LIFE TECHNOLOGIES, S.A

El 19 de desembre de 2018, va procedir-se a la realització de l'obertura del sobres amb les ofertes avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l'Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d'Obertura del Sobre Núm.2.

Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s'ha anat reproduint tenint en compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb el quadre de puntuacions de cada lot:

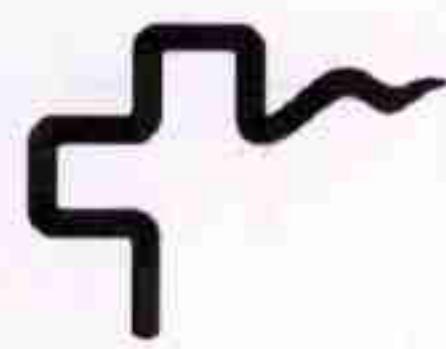

LOT 1

Característiques qualitatives i tècniques del subministrament dels productes i serveis inclosos a la licitació.....MÀXIM 50 PUNTS

6.1.1 Memòria tècnica i organització: 45 punts

- Memòria d'especificacions tècniques de l'equip a subministrar.
- Organització i mitjans de subministrament.
- Certificat de l'adjudicatari conforme disposa d'un sistema de qualitat tipus ISO9001:2015 o semblant.

6.2.1 Millores addicionals: 5 punts

- Ampliació de la garantia partint de la base que s'ha establert un termini mínim de garantia de dos (2) anys.

LOT 2

Característiques qualitatives i tècniques del subministrament dels productes i serveis inclosos a la licitació.....MÀXIM 50 PUNTS

6.1.2 Memòria tècnica i organització: 45 punts


- Memòria d'especificacions tècniques de les actualitzacions a realitzar
- Organització i mitjans de per a la prestació del servei
- Certificat de l'adjudicatari conforme disposa d'un sistema de qualitat tipus ISO9001:2015 o semblant.

6.2.2 Millores addicionals: 5 punts

- Ampliació de la garantia, partint de la base que s'ha establert un termini mínim d'un (1) any.

LOT 3

Característiques qualitatives i tècniques del subministrament dels productes i serveis inclosos a la licitació.....MÀXIM 50 PUNTS

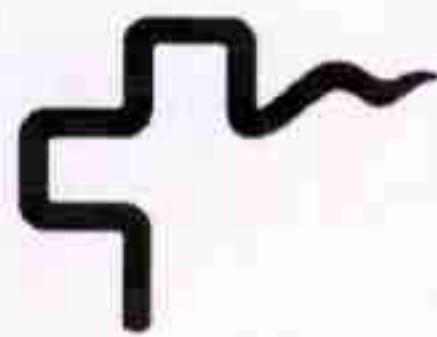

6.1.3 Memòria tècnica i organització: 45 punts

- Pla de treball i organització per al servei de manteniment preventiu i correctiu.
- Certificat de l'adjudicatari conforme disposa d'un sistema de qualitat tipus ISO9001:2015 o semblant.

6.2.3 Millors addicionals: 5 punts

- Reducció del temps de resposta (menys de 3 hores per a l'atenció remota inicial, menys de 3 dies laborables per a la resolució d'avaries in situ) 3 punts
- Ampliació del serveis de manteniment preventiu (LOT 3) per incloure les estacions fluídiques del sistema GCS3000 del que forma part el forn d'hibridació d'arrays demanat al LOT 1 2 punts

Exposat l'anterior, s'indica a continuació la puntuació que s'ha assolit per cada lot:

LOT 1: FORN D'HIBRIDACIÓ PER A MICROARRAYS


Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: 45 punts

CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNIQUES	LIFE TECHNOLOGIES, S.A
Memòria tècnica i organització. (<u>màx. 45 punts</u>).	45
PUNTUACIÓ TOTAL	45

Justificació de les valoracions:

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix les especificacions tècniques requerides. En conseqüència, se li atorga la màxima puntuació.

Millors Addicionals 5 punts

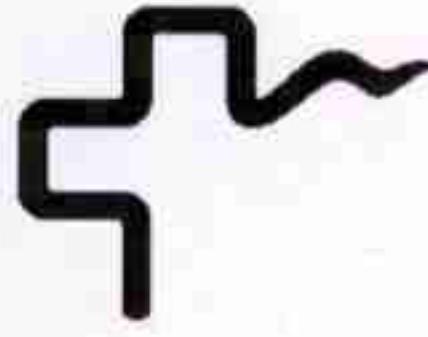

<u>MILLORES ADDICIONALS</u>	LIFE TECHNOLOGIES, S.A
Ampliació de la garantia partint de la base que s'ha establert un termini mínim de garantia de dos (2) anys.	0
PUNTUACIÓ TOTAL	0

Justificació de les valoracions:

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix les especificacions tècniques requerides, si bé no especifica la durada de la garantia de l'aparell subministrat. Per tant s'assumeix que aquesta és de 2 anys i no s'atorga cap puntuació a l'apartat de millores addicionals.


LOT 2: ACTUALITZACIÓ EQUIP GENETITAN A VERSIÓ MULTICHANNEL

Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: 45 punts

<u>CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNIQUES</u>	LIFE TECHNOLOGIES, S.A
Memòria tècnica i organització. (<i>màx. 45 punts</i>).	45
PUNTUACIÓ TOTAL	45

Justificació de les valoracions:

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix les especificacions tècniques requerides. En conseqüència, se li atorga la màxima puntuació.

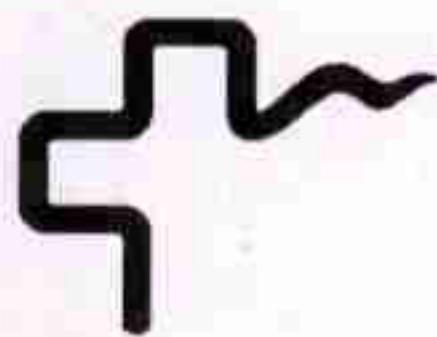

Millors Addicionals 5 punts

MILLORES ADDICIONALS	LIFE TECHNOLOGIES, S.A
Ampliació de la garantia, partint de la base que s'ha establert un termini mínim d'un (1) any.	0
PUNTUACIÓ TOTAL	0

Justificació de les valoracions:

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix les especificacions tècniques requerides, si bé no amplia la garantia de les peces reemplaçades (escàner i estació de treball) a més d'un any. Per tant, no s'atorga cap puntuació addicional en aquest apartat.

LOT 3: MANTENIMENT DE L'EQUIP GENETITAN


Característiques qualitatives i tècniques del subministrament: 45 punts

CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNIQUES	LIFE TECHNOLOGIES, S.A
Memòria tècnica i organització. <u>(màx. 45 punts)</u> .	45
PUNTUACIÓ TOTAL	45

Justificació de les valoracions:

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. compleix els requisits establerts tant en relació amb el manteniment preventiu com al correctiu. En conseqüència, se li atorga la màxima puntuació.

Millors Addicionals 5 punts

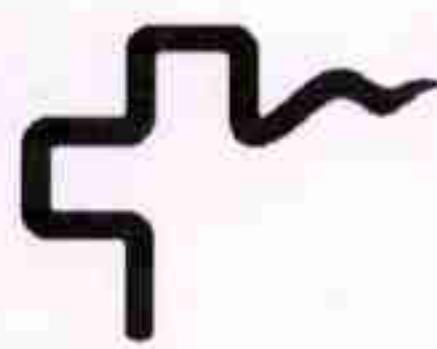

MILLORES ADDICIONALS	LIFE TECHNOLOGIES, S.A
Reducció del temps de resposta (menys de 3 hores per a l'atenció remota inicial, menys de 3 dies laborables per a la resolució d'avaries in situ) 3 punts	0
Ampliació del serveis de manteniment preventiu (LOT 3) per incloure les estacions fluídiques del sistema GCS3000 del que forma part el forn d'hibridació d'arrays demanat al LOT 1 2 punts	0
PUNTUACIÓ TOTAL	0


Justificació de les valoracions:

L'empresa LIFE TECHNOLOGIES S.A. no proporciona cap de les millores addicionals incloses en aquest apartat. En conseqüència, no se li atorga cap punt addicional.

A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual s'acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui lloc l'obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 2 de gener de 2018 a les 9:00h a la Sala de Reunions de la 2^a Planta de l'Edifici Mediterrània, tal i com s'anuncia a les bases de la present licitació publicades a la web del VHIR.

LOT 1

Ofertes presentades:	Oferta econòmica	QUADRE DE PUNTUACIONS			Aspectes Tècnics	5% Millores	TOTAL
		BI	IVA	TOTAL			
LIFE TECHNOLOGIES, S.A					45	0	45

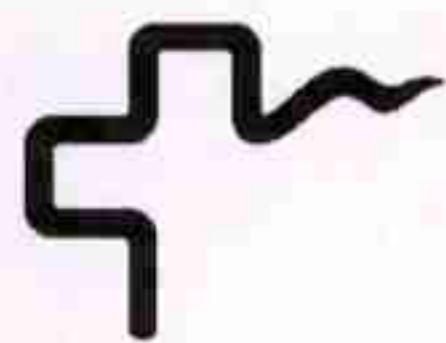

LOT 2

Ofertes presentades:	Oferta econòmica	QUADRE DE PUNTUACIONS			Valor. Econòmica.	Aspectes Tècnics	5% Millores
		50%	45%	5%			
		BI	IVA	TOTAL			
LIFE TECHNOLOGIES, S.A						45	0
							45

LOT 3

Ofertes presentades:	Oferta econòmica	QUADRE DE PUNTUACIONS			Valor. Econòmica.	Aspectes Tècnics	5% Millores
		50%	45%	5%			
		BI	IVA	TOTAL			
LIFE TECHNOLOGIES, S.A						45	0
							45

Barcelona, 20 de Desembre de 2018.

Dra. Rosario M. Prieto Sánchez
Cap de la Unitat d'Alta Tecnologia (UAT).
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron -Institut de Recerca (VHIR).